HP 版

訪問看護

QOCORO 連携ツール Ver1.8.0.0
バージョンアップ手順書

2023/12/12

目次

1　バージョンの確認 2
2　バージョンアップ作業 3
2.1　コスモス親機のバージョンアップ 3
2.2　連携ツールのバージョンアップ 5
3　バージョン確認 8

バージョンアップは、連携ツールがインストールされているすべての PC と
Flowers NEXT コスモスの親機で行ってください。

【注意】Flowers NEXT コスモスの親機に連携ツールがインストールされていない
場合も、必ずバージョンアップを行ってください。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

1　バージョンの確認

データ連携ツールを起動します。画面左下にある「バージョン情報」を確認します。

<差し替え対象バージョン>

1.0.7.0、1.0.9.0、1.0.12.0
1.1.1.0、1.1.2.0、1.1.4.0
1.2.1.0、1.2.3.0、1.2.5.0
1.2.6.0、1.3.0.0、1.4.0.0
1.5.0.0、1.5.0.1、1.6.0.0

※差し替え対象バージョン以外の場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

2　バージョンアップ作業

2.1 コスモス親機のバージョンアップ

※親機で作業を行ってください。（親機に連携ツールが入っていない場合も必ず行ってください。）

①　「お客様サポート」ホームページの「お知らせ」から、「QOCORO 連携ツール Ver.1.8.0.0 はこちらからダウンロード」を開き、「QOCORO 連携ツール Ver.1.8.0.0」をクリックします。
続けて、「ダウンロード開始」をクリックします。

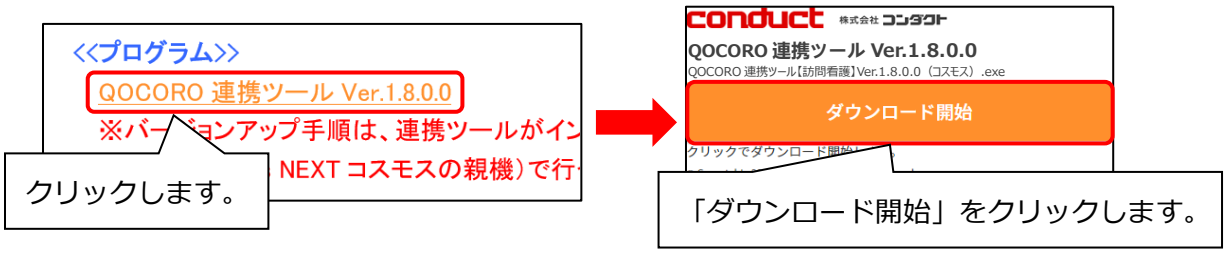

②　画面右上に表示されるメッセージから、ダウンロードしたファイルを開きます。

Microsoft Edge をお使いの場合

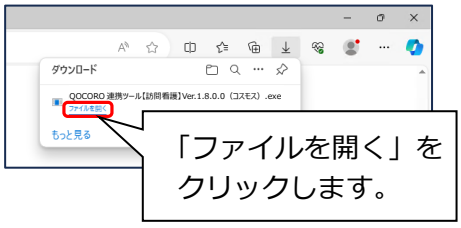

Google Chrome をお使いの場合

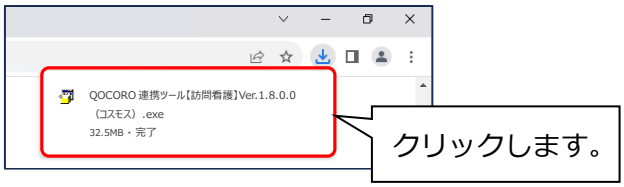

③　「QOCORO 連携ツール画面は閉じましたか？」と表示されます。
QOCORO 連携ツールが起動している場合は画面を閉じ、「はい」をクリックします。

④　「展開先の指定」画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

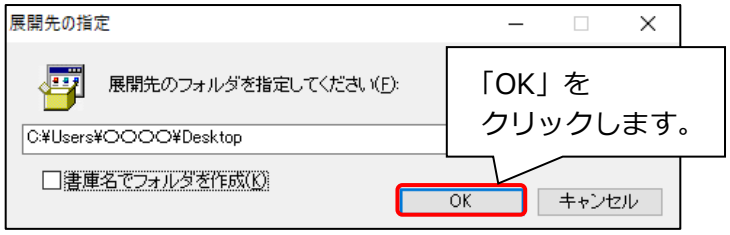

※基本的には、デスクトップに保存をお願いします。

⑤　ユーザーアカウント制御の画面（このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？）が表示されますので、「はい」をクリックします。

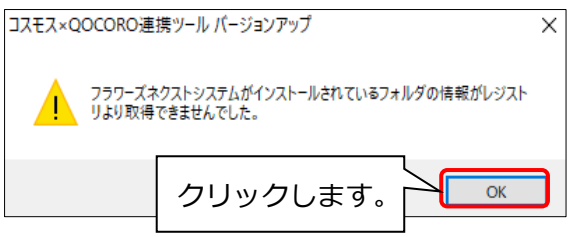

【補足】
親機にコスモスがインストールされていない場合は、以下のメッセージが表示されます。
表示された場合は「OK」をクリックしてください。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

⑥　「コスモス×QOCORO 連携ツール バージョンアップ」画面が表示されますので、
「バージョンアップ」をクリックします。

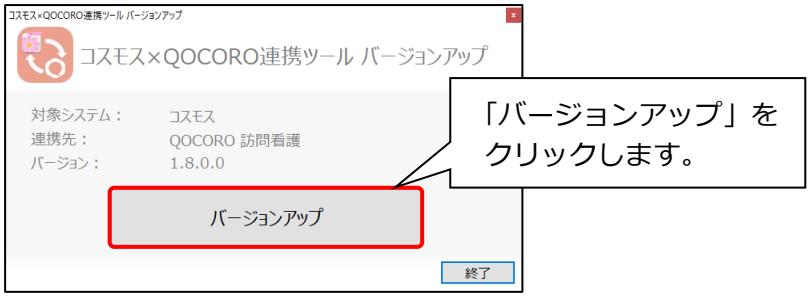

⑦　確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

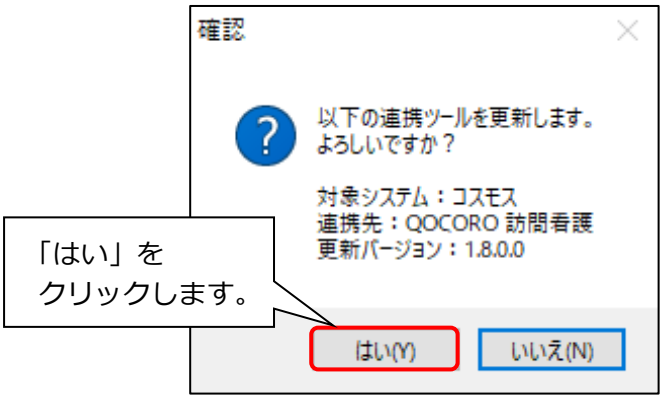

⑧　完了メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

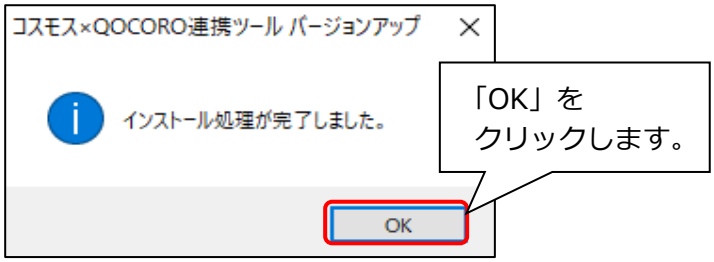

⑨　「終了」をクリックします。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

2.2 連携ツールのバージョンアップ

※ 連携ツールがインストールされているパソコンすべてで作業を行ってください。
連携ツールが親機にのみインストールされている場合で、手順「2.1 親機のバージョンアップ」がお済みの場合は、この作業は不要です。

① 「お客様サポート」ホームページの「QOCORO 連携ツール Ver.1.8.0.0 はこちらからダウンロード」を開き、「QOCORO 連携ツール Ver.1.8.0.0」をクリックします。
続けて、「ダウンロード開始」をクリックします。

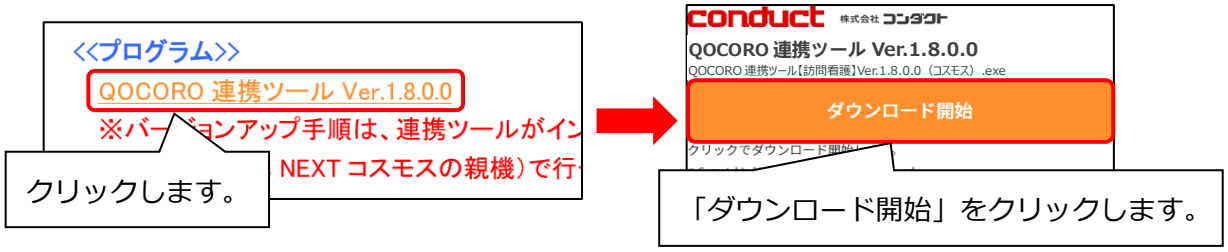

② ダウンロードしたファイルを開きます。

Microsoft Edge をお使いの場合

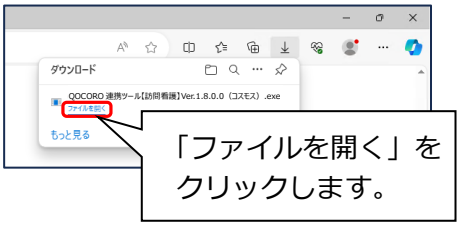

Google Chrome をお使いの場合

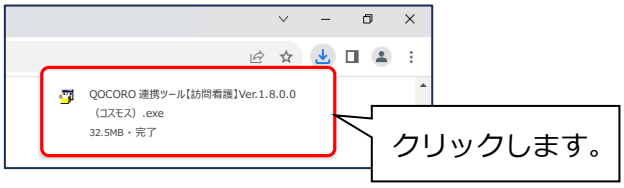

③ 「QOCORO 連携ツール画面は閉じましたか？」の確認メッセージが表示されます。
QOCORO 連携ツールが起動している場合は、閉じて、「はい」をクリックします。

④ 「展開先の指定」画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

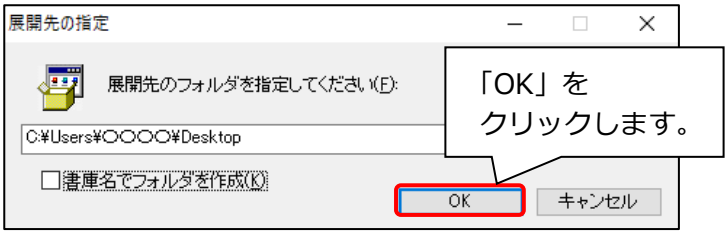

※基本的には、デスクトップに保存をお願いします。

⑤ ユーザーアカウント制御の画面（このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？）が表示されますので、「はい」をクリックします。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

⑥　「コスモス×QOCORO 連携ツール バージョンアップ」画面が表示されますので、
「バージョンアップ」をクリックします。

⑦　確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

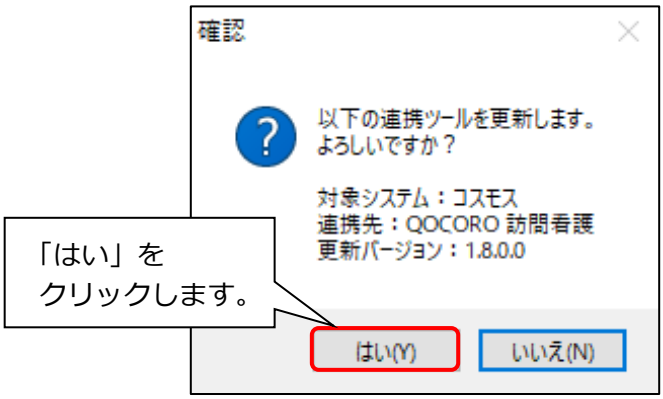

⑧　完了メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

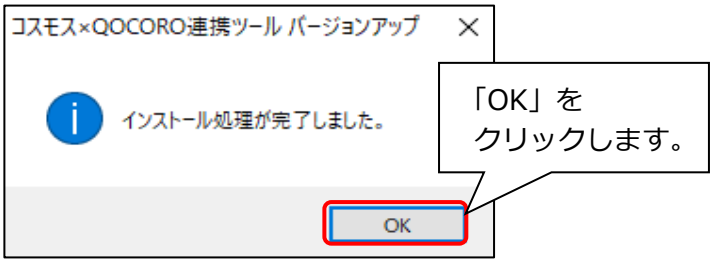

⑨　以下のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
※ このメッセージは、親機のバージョンアップを行っていても表示されます。

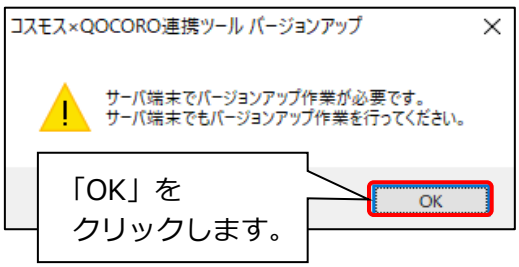

3 ページの手順「2.1 コスモス親機のバージョンアップ」を行っていない場合は、
親機でもバージョンアップを行ってください。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

⑩　「終了」をクリックします。

⑪　連携ツールがインストールされているすべての PC で①～⑩を行ってください。
すべての PC でバージョンアップが終わるまでは、QOCORO 連携ツールを起動しないでください。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

3　バージョン確認

QOCORO 連携ツールを起動します。
画面左下に「バージョン情報 1.8.0.0」と表示されていることを確認します。

※ 連携ツールが入っているすべての PC で「バージョン情報 1.8.0.0」と表示されていることを確認してください。

※ 今回のバージョンアップには添付書類はありません。（一部不具合の修正対応のみのため。）

※ QOCORO 連携ツールを起動したときにメッセージが表示された場合は、「後で移行する(閉じる)」をクリックしてから「バージョン情報」を確認してください。
（→p.9 をご覧ください）

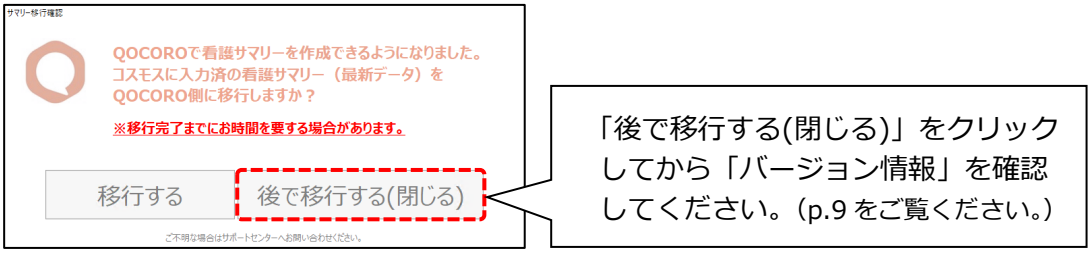

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.

■QOCORO 連携ツールを起動したときにメッセージが表示される場合

前回（2022/9/21 リリース）のバージョンアップを行わずに、今回（Ver1.8.0.0）のバージョンアップを行うと、QOCORO 連携ツールの起動時に「QOCORO で看護サマリーを作成できるようになりました。」と表示されることがあります。

このメッセージが表示された場合は、以下の手順で過去の添付書類を開き、手順に従って QOCORO アプリや連携ツールの操作を行ってください。

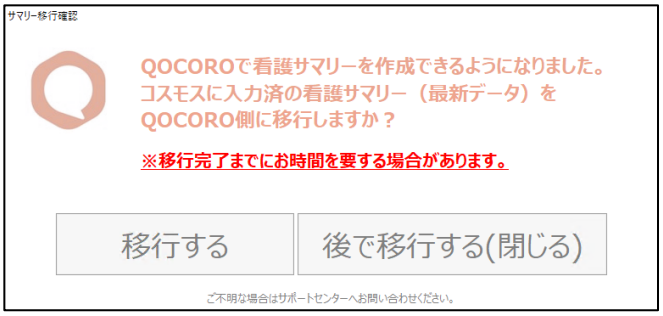

＜手順＞

（1）「お客様サポート HP」の「QOCORO 連携ツール Ver.1.8.0.0 はこちらから ダウンロード」のページに戻り、「月別アーカイブ」の「2022 年 9 月」をクリックします。

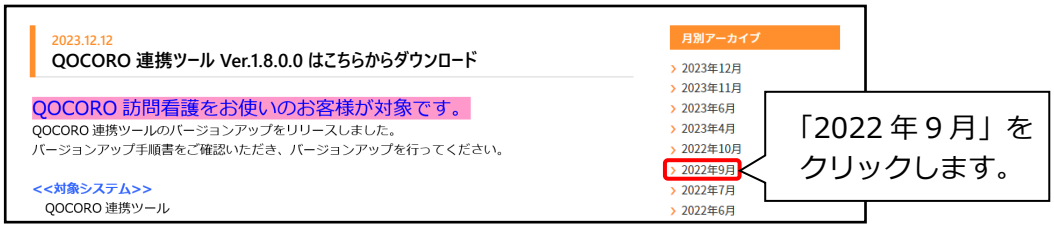

（2）「QOCORO 連携ツール Ver1.6.0.0 はこちらからダウンロード」画面が表示されます。「【手順書】QOCORO 看護サマリーの移行について Ver1.6.0」をクリックします。

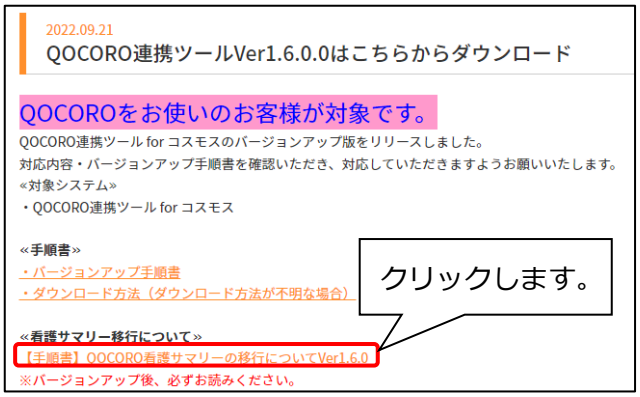

（3）ダウンロードした PDF ファイルを開き、内容を確認します。
手順に従って QOCORO アプリや連携ツールの操作を行ってください。

ご案内は以上です。

©2023 CONDUCT All Rights Reserved.